

Số: 458./TM-TTYT
Về việc mời cung cấp báo
giá dịch hàng hóa

Văn Chấn, ngày 20 tháng 06 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ hàng hóa

Về việc “Mua sắm lắp đặt bổ sung hệ thống xông sàn chậu khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản phục vụ công tác hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh tại TTYT huyện Văn Chấn năm 2025”

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH ngày 29/11/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu;

Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm lắp đặt bổ sung hệ thống xông sàn chậu khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản phục vụ công tác hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh tại TTYT huyện Văn Chấn năm 2025” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà: Trần Thị Phượng - số điện thoại: 0979.892.638

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn Thư TTYT huyện Văn Chấn, Tổ dân phố 9, thị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
- Nhận qua email: vanthuytvc@gmail.com bản Scan có dấu đỏ của nhà cung cấp

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 20 tháng 06 năm 2025 đến trước 08h00 ngày 26 tháng 06 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

(có phụ lục kèm theo)

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các Nhà cung cấp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đình Liên

Phụ lục số 01

(Vị trí thực hiện kèm theo công văn số 458 TM-TT/TT ngày 20/06/2025 của TTYT huyện Văn Chấn)


Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản Trung tâm y tế huyện Văn Chấn

Dãy nhà: D

Số tầng: 02

Số Phòng: 17


Diện tích phòng 19,8.m² Kích thước: Dài: 6.m; rộng 3,3m

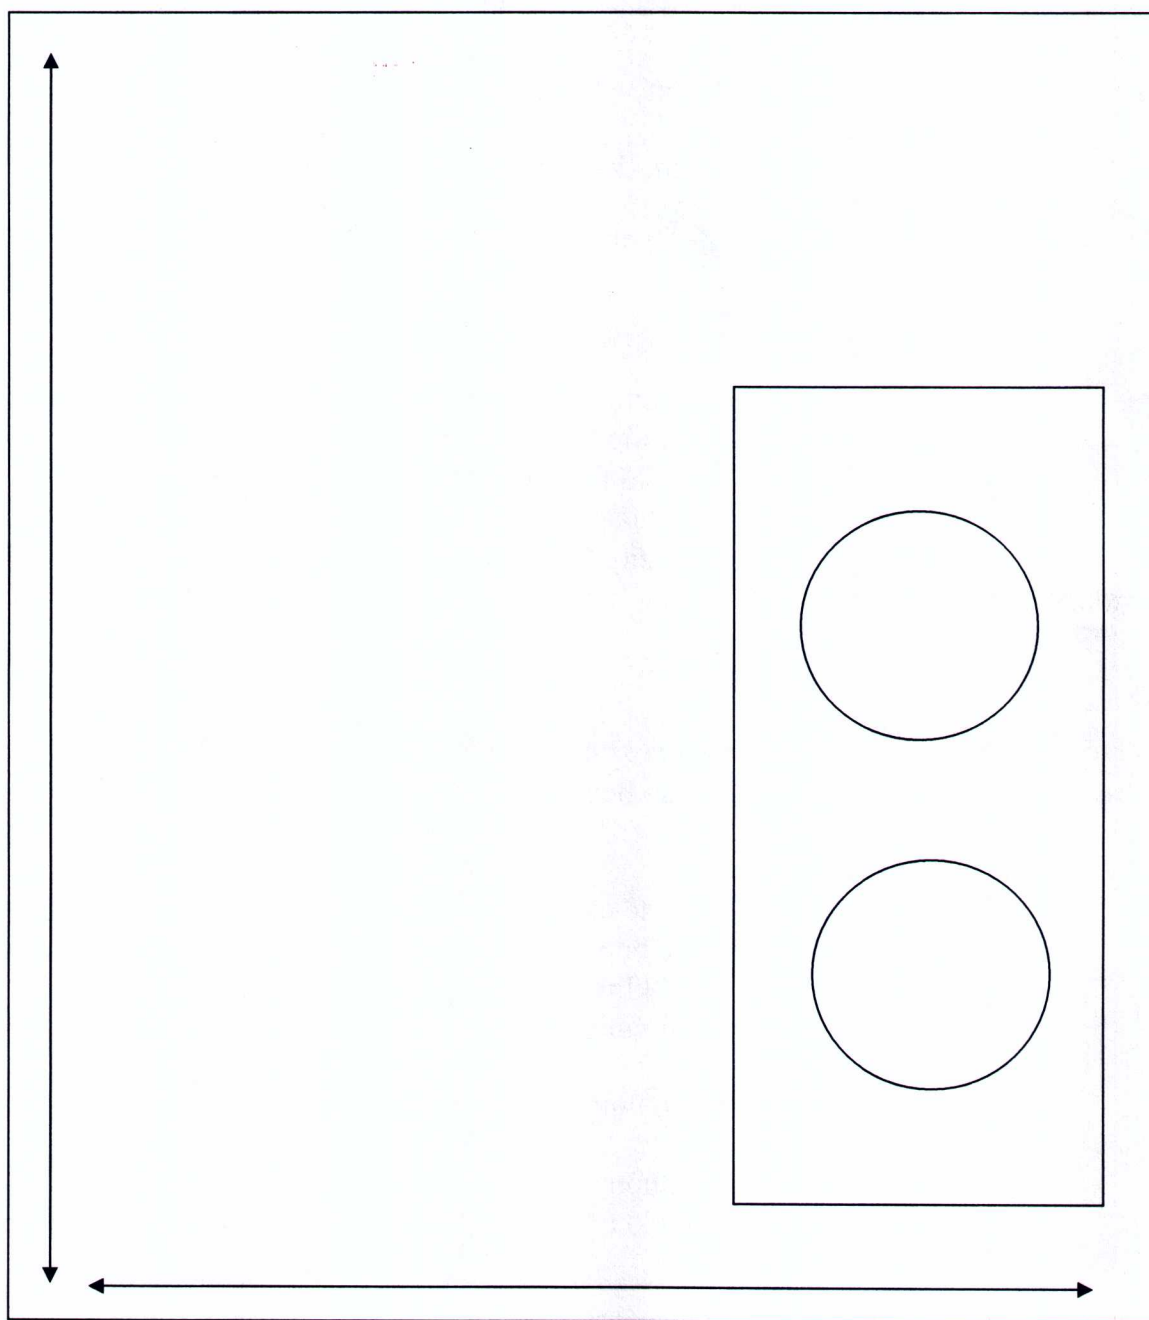

Phụ lục số 02

(Kính gửi thực hiện kèm theo công văn số 458 /TM-TTYT ngày 20/ 06 /2025 của TTYT huyện Văn Chấn)

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật yêu cầu	ĐVT	Số lượng
1	Ghế xông	Kích thước tổng thể: - Chiều dài: 600. cm - Chiều rộng: 500 cm - Chiều cao: 8500 cm, (bao gồm cả phần tựa lưng) - Chiều cao ghế ngồi: 400 cm - Trọng lượng: 40kg Thiết kế ghế: Hình dạng: Ghế có phần ngồi rộng ở giữa, cho phép hơi nước tiếp xúc trực tiếp với vùng sàn chậu; Tựa lưng: Có thể điều chỉnh góc nghiêng (0–45 độ) để tạo sự thoải mái. Tay vịn: Được thiết kế để người dùng giữ thẳng bằng, thường bọc đệm mềm hoặc nhựa y tế. Chất liệu: Khung ghế: tấm nhựa không gỉ hoặc hợp kim inox304 , đảm bảo độ bền và chống ăn mòn trong môi trường ẩm. Bề mặt ghế: Nhựa y tế cao cấp (ABS hoặc polypropylene) hoặc bọc da y tế, dễ vệ sinh, chống thấm nước. Chống vi khuẩn, không gây kích ứng da, đặc biệt phù hợp với vùng nhạy cảm. Bình chứa nước/thảo dược: Chất liệu: inox304 không gỉ chịu nhiệt cao, dung tích khoảng 2–5 lít. Có nắp đậy kín để ngăn hơi nước thoát ra ngoài. 3. Hệ thống tạo hơi nước	Cái	02



Công suất:

Bộ gia nhiệt: 1000–1500 W, tùy model, đảm bảo làm nóng nước nhanh trong 3–5 phút.

Nhiệt độ hơi nước:

Phạm vi điều chỉnh: 35–50°C, được kiểm soát bằng bộ điều chỉnh nhiệt độ để tránh bỏng.

Nhiệt độ tối ưu: ~40–45°C, phù hợp với vùng sản chậu nhạy cảm.

Dung tích bình nước:

2–5 lít, đủ cho 1–5 liệu trình xông (mỗi liệu trình ~15 phút).

Hệ thống phun hơi:

Hơi nước được dẫn qua ống dẫn chuyên dụng, phân bố đều ở khu vực ghế ngồi.

Có thể điều chỉnh cường độ phun hơi (mạnh/yếu) để phù hợp với người dùng.

An toàn:

Hệ thống tự ngắt khi quá nhiệt hoặc hết nước.

Vật liệu cách điện, chống rò rỉ điện trong môi trường ẩm.

5. Nguồn điện và vận hành

Nguồn điện: 220V/50Hz

Công suất tổng: 1000–1500 W, tùy thuộc vào tính năng (xông hơi, massage, cảm biến).

Độ ồn: Dưới 50 dB, đảm bảo không gây khó chịu trong không gian điều trị.

6. Tiêu chuẩn y tế và bảo hành

Tiêu chuẩn:

Tuân thủ các tiêu chuẩn y tế quốc tế (ISO 13485, CE)

		 hoặc tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN). Được kiểm định bởi Bộ Y tế hoặc các cơ quan có thẩm quyền. * Bảo hành: 12 tháng		
2	Bục xông	Kích thước: Dài: 200 cm Rộng: 100 cm Dày: 20 cm Chất liệu: Gỗ dán chống ẩm + Khung sắt. Tấm nhựa dán sàn vân gỗ - Khung bằng sắt mạ tĩnh điện chống rỉ sét, đảm bảo chịu lực chịu tải - Gỗ chống ẩm mỗi một cong vênh (độ dày: 17 cm)	Cái	01
3	Óp vách ngăn	Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp (hoặc SPC) Kích thước tiêu chuẩn: • Chiều rộng: 400mm Chiều dài: 3000mm Độ dày: 8mm Lớp bảo vệ bề mặt: Phủ UV (3 lớp) hoặc nano, chống trầy xước, chống bám bẩn, chống tia UV, tăng độ bền màu. Lớp đế PVC/SPC: Lỗ rỗng, chứa các ô khí, cách âm, cách nhiệt, chống thấm, tăng độ cứng. Đặc tính kỹ thuật: Chống thấm nước: 100%; Chống ẩm mốc, mối mọt: Không bị mục nát, phù hợp khí hậu nóng ẩm. Thân thiện môi trường: Nhựa nguyên sinh, không chứa lưu huỳnh, thủy ngân, có thể tái chế.	m ²	18