

Số: 73 /TM-TTYT
Về việc mời cung cấp Báo giá dịch vụ tư vấn

Thượng Bằng La, ngày 13 tháng 8 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: **Các nhà cung cấp dịch vụ tư vấn**

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 26 tháng 06 năm 2023;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 QH khóa XV về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin đấu thầu và mẫu hồ sơ mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Trung tâm Y tế Khu vực Văn Chấn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dịch vụ tư vấn cho gói thầu: “Thiết bị y tế (Nhóm dụng cụ, Vật tư cận lâm sàng) năm 2025 của Trung tâm Y tế Khu vực Văn Chấn” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Khu vực Văn Chấn, tỉnh Lào Cai.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Cao Ngọc Thủy; SĐT: 0944683968

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn Thư - Trung tâm Y tế Khu vực Văn Chấn, Thôn 9, xã Thượng Bằng La, tỉnh Lào Cai.

- Hoặc qua email: baogiavanchan@gmail.com bản Scan có dấu đỏ của nhà cung cấp (Lưu ý: Báo giá phải được người có thẩm quyền ký trực tiếp trên văn bản giấy, khi ký văn bản dùng bút có mực màu xanh, không dùng các loại mực để phai hoặc dùng dấu chữ ký khắc sẵn để ký báo giá).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h00 ngày 13 tháng 8 năm 2025 đến trước 15h00 ngày 15 tháng 8 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Tư vấn lập E- HSMT, đánh giá HSDT


2. Tư vấn thẩm định E- HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các Nhà cung cấp dịch vụ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

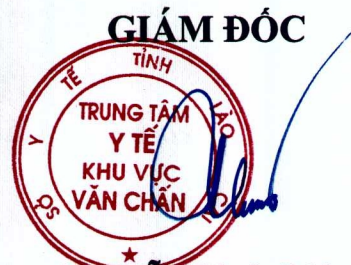

Nguyễn Đình Liên



PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA KÈM THEO


(Kèm theo Thư mời Báo giá số 73 /TM-TTYT ngày 13/8/2025 của Trung tâm Y tế Khu vực Văn Chấn)

STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật/đặc tính chung của hàng hóa, Tiêu chí chất lượng	Mã	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Bóp bóng Ambu giúp thở Size L	- Dây oxy chất liệu PVC dài khoảng 2m ($\pm 5\%$). - Mặt nạ chất liệu PVC, PC - Khoảng chết: khoảng dưới 6ml. - Trờ kháng hít vào, thở ra $\leq 5\text{cm H}_2\text{O}$ tại 50LMP. - Bộ gồm bóng bóp có van một chiều, mask thở, dây nối, túi đựng khí. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016		Cái	2	240.000	480.000
2	Mask bóp bóng (Mask Ambu) - Size XS và S	- Dây oxy chất liệu PVC dài khoảng 2m ($\pm 5\%$). - Mặt nạ chất liệu PVC, PC - Khoảng chết: khoảng dưới 6ml. - Trờ kháng hít vào, thở ra $\leq 5\text{cm H}_2\text{O}$ tại 50LMP. - Bộ gồm bóng bóp có van một chiều, mask thở, dây nối, túi đựng khí. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016		Cái	4	240.000	960.000
3	Mask bóp bóng (Mask Ambu)- Size L	- Dây oxy chất liệu PVC dài khoảng 2m ($\pm 5\%$). - Mặt nạ chất liệu PVC, PC - Khoảng chết: khoảng dưới 6ml. - Trờ kháng hít vào, thở ra $\leq 5\text{cm H}_2\text{O}$ tại 50LMP. - Bộ gồm bóng bóp có van một chiều, mask thở, dây nối, túi đựng khí. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016		Cái	2	240.000	480.000
4	Gel siêu âm	- Hỗ trợ trong siêu âm chẩn đoán hình ảnh để sóng siêu âm được truyền tự do giữa cơ thể và đầu dò giúp truyền tín hiệu đến máy siêu âm để tạo ra hình ảnh. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016		Lít	600	42.000	25.200.000
5	Giấy in Monitor sản khoa (151 mm x 100 mm x 150sh)	- Làm từ bột giấy, không chứa clo và carbon, được xử lý phủ lớp nhạy nhiệt trên cùng, dính mực tốt, in rõ nét. - Kích thước: 151mm x 100mm x 150 tờ		Xấp	600	52.000	31.200.000
6	Giấy in siêu âm đen	- Kích thước: 110mm x 20m,		Cuộn	600	158.000	94.800.000



	trắng AC 110	- Dùng một lần					
7	Giấy in nhiệt điện tim (sử dụng được cho máy Kenz Cardico 306)	- Sử dụng được cho máy Kenz Cardico 306 - Làm từ bột giấy, không chứa clo và carbon, được xử lý phủ lớp nhạy nhiệt trên cùng, dính mực tốt, in rõ nét. - Kích thước: 80mm x 20m		Cuộn	600	23.000	13.800.000
8	Giấy điện tim (sử dụng được cho máy Kenz 302, 112X90-300P)	- Sử dụng được cho máy Kenz 302, 112X90-300P - Làm từ bột giấy, không chứa clo và carbon, được xử lý phủ lớp nhạy nhiệt trên cùng, dính mực tốt, in rõ nét - Kích thước: 112mm x 90mm x 300 sheets		Xấp	400	71.000	28.400.000
9	Giấy in nhiệt (sử dụng được cho máy xét nghiệm huyết học, đông máu, nước tiểu) Kích thước 5cm x 20m	Làm từ bột giấy, không chứa clo và carbon, được xử lý phủ lớp nhạy nhiệt trên cùng, dính mực tốt, in rõ nét. Kích thước 5cm x 20m		Cuộn	200	23.000	4.600.000
10	Cán dao mổ - số 3 (dài 12.5cm)	- Dài 12.5cm, - Thép không gỉ. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016		Cái	1	290.000	290.000
11	Dụng cụ đo huyết áp cơ	- Đồng hồ đo tối thiểu có quả bóp làm bằng chất liệu cao su, van xả khí được mạ Crom nhằm chống oxy hóa và có độ bền cao, mặt đồng hồ được làm bằng kính chịu lực - Đồng hồ hiển thị kết quả chính xác, vạch chia từ 20 ~ 300mmHg, độ chính xác cao - Đã có kiểm định		Cái	48	540.000	25.920.000
12	Panh thẳng không máu - 16cm	- Chiều dài 16cm - Quy cách: 1 cái/túi - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016	F6-043	Cái	7	110.000	770.000
13	Panh thẳng không máu - 20cm	- Chiều dài 16cm - Quy cách: 1 cái/túi - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2017	F6-006	Cái	12	155.000	1.860.000
14	Kẹp phẫu tích không máu (dài 14cm)	Chất liệu: thép ko gỉ - Kẹp phẫu tích không máu (dài 14cm) - Quy cách: 1 cái/túi - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2017	F5-398	Cái	42	75.000	3.150.000
15	Kẹp phẫu tích không máu (dài 16cm)	Chất liệu: thép ko gỉ - Kẹp phẫu tích không máu (dài 16cm)	F5-399	Cái	42	85.000	3.570.000

		- Quy cách: 1 cái/túi - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2018					
16	Kéo thẳng - nhọn/nhọn (dài 14cm)	Chất liệu: thép ko gỉ - Kéo thẳng - nhọn/nhọn (dài 14cm) - Quy cách: 1 cái/túi - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2019	TCF4 - 489	Cái	43	75.000	3.225.000
17	Nhiệt kế thủy ngân	- Có thể đo qua miệng, trực tràng, qua nách - Vật liệu cảm biến nhiệt độ: Thủy ngân - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2017		Cái	200	25.000	5.000.000
18	Máy châm cứu 6 giác	- Cường độ từ trường hạt từ: khoảng 2000 - Công suất tiêu hao tối đa: $\leq 5kW$. - Tiêu chuẩn an toàn: Type II-BF - Điện năng cung cấp cho Adapter: Đầu vào:220V/50Hz, Đầu ra: DC9V/150mA. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016	KWD-808	Cái	5	1.920.000	9.600.000
19	Kìm sinh thiết nóng	HBFO5-11023230 Kìm sinh thiết nóng đa chức năng giúp loại bỏ các polyp không cuống ở trạng thái kích hoạt dòng điện và được sử dụng như cầm máu, có lớp phủ cách điện ngăn dòng điện tiếp xúc với mô; ngăn chất liệu thép không gỉ dùng trong y tế bền tạo vết cắt sắc, ít chảy máu; ngàm có thể tái định vị giúp định vị lại và căn chỉnh chính xác hơn. Tay cầm thiết kế tiện dụng, kiểm soát tối ưu. ĐK ngoài: 2.3mm; chiều dài làm việc 2300mm. ĐK kênh làm việc 2.8mm.		Cái	10	210.000	2.100.000
20	Filter lọc khuẩn dùng cho máy thở	- Lọc vi khuẩn là một bộ phận lắp thêm vào đường dây máy thở, máy gây mê, máy đo chức năng hô hấp nhằm lọc vi khuẩn, virus, làm ẩm và làm ấm khí thở - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016		Cái	2.000	32.000	64.000.000
21	Bóng đèn cực tím 60cm	- Dài 60cm, dùng để tiệt tiêu vi khuẩn có hại - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016		Cái	60	110.000	6.600.000
22	Đèn hồng ngoại	Công suất 250W, tăng giảm được; Dây nguồn 3m; Có chức năng Dimmer (tăng giảm độ nóng); Điều chỉnh chiều cao từ 1m – 1,7m; Cố định vị xoay linh động đến gần 360 độ khoảng rộng 30cm + 30cm; Đuôi đèn Ceramic E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn		Cái	6	980.000	5.880.000
23	Dây nối bơm tiêm	Được làm từ chất liệu PVC Y tế.	IF-BR-001	Cái	400	13.000	5.200.000



	điện	100 cái hộp Đạt tiêu chuẩn ISO 13485					
	Tổng cộng: 23 khoản						337.085.000